

重要！

必ず下記の手順を守って、終了操作を行ってください。
手順通りでないと、次回正常に起動することができない場合があります。

終了方法



③ メイン電源を切ります



④ モニターの電源を切ります



④ 体温計・パルスオキシメータの電源を切ります



●ご使用時以外、体温計やパルスオキシメータの電源をお切りください。

電源を入れていると、電池の消耗が早くなったり故障の原因となります。

●体温計やパルスオキシメータの電池が少なくなったら速やかに交換してください。

電池が減ると液晶画面に"Lo"と表示されます。故障の原因となりますので、電池を交換してください。単4電池をお使いください。


付属機器の各部の名称と機能

■ コントロールPC



■ コントロールPCドッグ

・前面

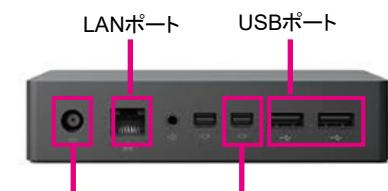

・後面



■ キーボード



■ 生体情報モニター



■ パルスオキシメータ



■ 体温計



※コントロールPC、生体情報モニター、接続ポート等の仕様は、変更になることがあります。

株式会社 **京都科学**

<http://www.kyotokagaku.com>

■本社・工場

〒 612-8388

京都市伏見区本郷小屋町15番地
TEL:075-605-2510

FAX:075-605-2519

■東京支店

〒 113-0033

東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG 本郷三丁目ビル2階
TEL:03-3817-8071
FAX:03-3817-8075